



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ  
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,  
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,  
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,  
<http://www.nccd.gov.mn>

2024.03.22 № 4-1/304

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т


**ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ  
ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Тус төвийн Сүрьеэгийн клиникийн сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээний тасагт шаардлагатай цахилгаан соруулгын аппарат /отсост/ худалдан авахаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дах заалтыг үндэслэн 2024 оны 03 дугаар сарын 27–ны өдрийг хүртэл үнийн санал ирүүлнэ үү.

Саналыг байгууллагын албан тоотоор баталгаажуулан холбогдох материалын бүрдлийг ханган tender@nccd.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт...хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН  
АЛБАН ҮҮРГИЙГ  
ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

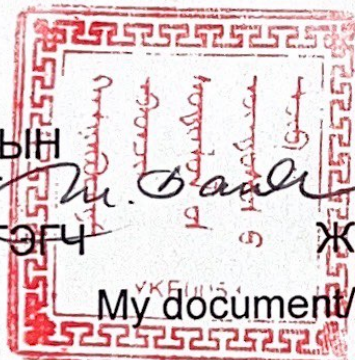

Ж. БАЙГАЛМАА

My document/2024 alban toot

ХӨСҮТ-ийн 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1/1 тоот албан бичгийн хавсралт



### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо	Үзүүлэлт
1	Цахилгаан соруулгын аппарат /Отсос/	ширхэг	2	Цахилгаан тэжээл: 220Вт ±5% 50-60Гц Хамгийн их вакум соролт : ≥680 mmHg (0,09МПа) Хамгийн бага вакум соролт: ≤150 mmHg (0.02МПа) Урсгалын хурд: ≥70л/мин Шуурианы түвшин: ≤60dB(A) Шингэн хуримтлуулах сав: ≥12л Савны тоо: ≥2 Жин: ≤22кг Нөөц савтай бол давуу.